
Fehlerhafte LAB löschen

ES gibt die Möglichkeit fehlerhafte LAB zu löschen, die nicht in einen Auftrag eingelesen werden sollen.

FEPA Funktion: `Vertrieb > EDI > LAB > LAB löschen`

1. Funktion öffnen
2. Im Reiter "Fehlerhaft" die Suche aufklappen
3. den eigenen Mandant auswählen
4. die Suche einschränke, ggf. über die DFÜ Kunden-Nr.
5. Suchen, Lupe drücken
6. Über die Spalte "Selektion" den/die LAB anhaken, der gelöscht werden soll
7. Speichern drücken, damit wird der /die LAB gelöscht und das Fenster wird geschlossen

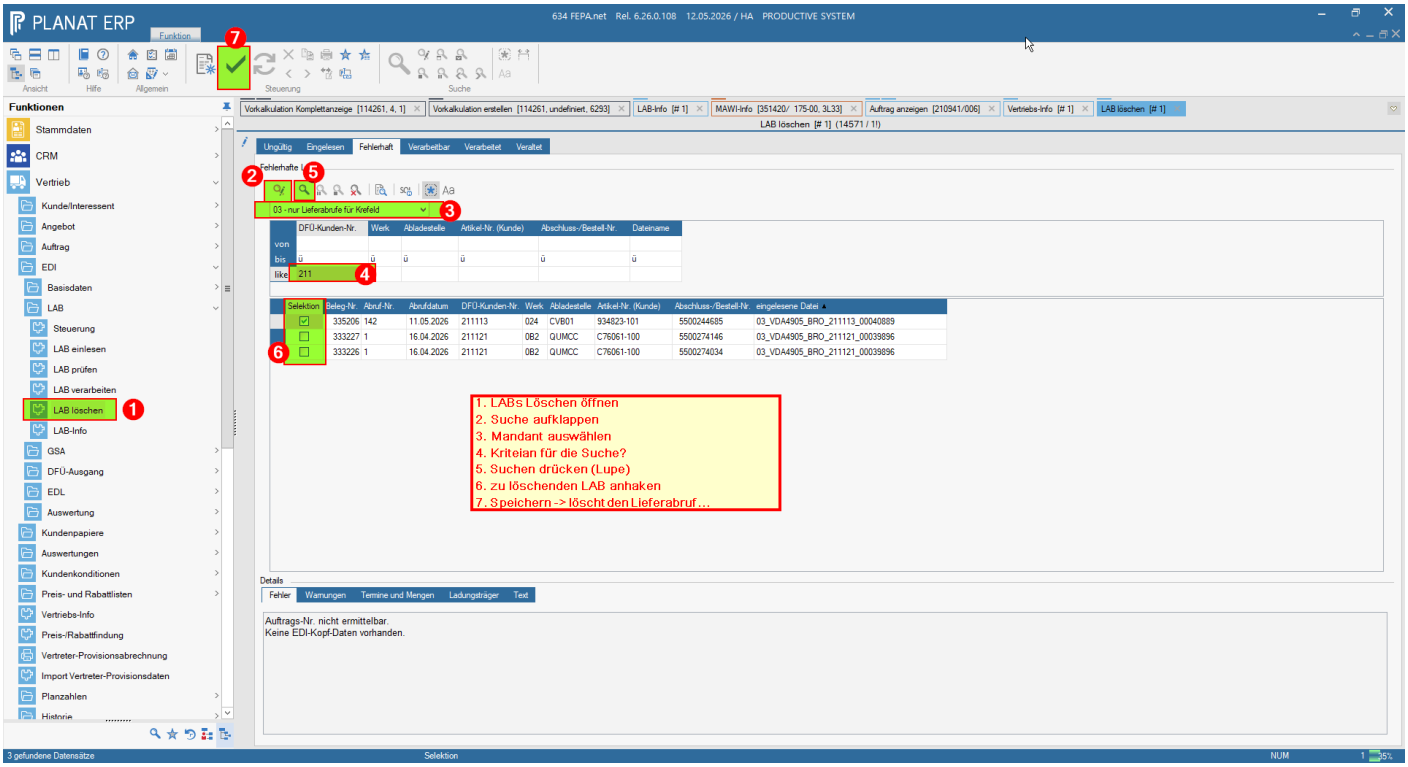

Revision #1
Created 12 May 2026 08:26:25 by Admin
Updated 12 May 2026 09:53:35 by Admin